


「改訂新版 テスターとディジタル・マルチメータの使い方」の訂正とお詫び

CQ出版株式会社

本書の以下の記述に誤りがありました。お買い求めいただいた読者諸兄にはご迷惑をおかけし、誠に申しわけございません。訂正いたしますとともににお詫び申し上げます。

p.34 図2.16 「整流回路の種類」(d)

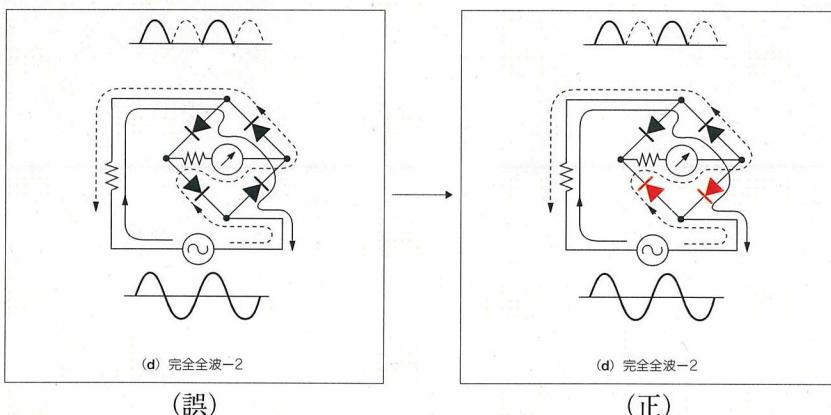

p.55 下から12行目

次に表3.7で、DC200Vレンジで真値（誤）

→次に表3.7で、DC400Vレンジで真値（正）

p.55 下から11行目

PM3型の場合は、真値が100V、レンジが200Vですから（誤）

→PM3型の場合は、真値が100V、レンジが400Vですから（正）

p.55 下から8行目

同様に、PC510型の200Vレンジで測定（誤）

→同様に、PC510型の500Vレンジで測定（正）